**2008 年 02 月 20 日（第 2 版）
2007 年 07 月 18 日（初版）

製品届出番号 27B3X000069000016

器具器械９　汎用Ｘ線診断装置用電動式患者台(40655000)
一般医療機器（特定保守管理医療機器・設置管理医療機器）
立位撮影台ＳＡ－０７－ＯＭＣ

【警告】

１．Ｘ線防護について

Ｘ線装置を誤って使用すると、身体に危害を及ぼす場合があります。

２．被験者に関する警告

・被検者が支柱部のレール、ワイヤーロープに触れない様ご指導願います。ケガや、衣服を汚す恐れがあります。

・被検者が撮影位置に立つ時基台につまずかない様ご指導願います。

・被検者が受像部の稼動部分に触れない様ご指導願います。受像部を上下移動させた場合、身体の一部が挟まりケガをする恐れがあります。

３．使用上の警告

・操作者は常に被ばくを防ぐ様に注意して下さい。
特に撮影中に撮影室に入室する必要のある時は、防護衣、防護装置等を使用し不必要な被ばくのない様に充分注意して下さい。

・受像部の保持部には指定以外の物を装着しないで下さい。
バランス不良による、ケガの恐れがあります。

・カセッテホルダー部に２５０Ｎ以上の荷重をかけて使用しないこと。

【禁忌・禁止】

・この装置は防爆型ではないので、装置の近くで可燃性及び爆発性の気体を使用しないこと。

・妊婦・産婦へのＸ線照射は避けて下さい。

・小児への過剰なＸ線照射は避けて下さい。

【形状・構造等】

１）構成

本装置は以下のユニットにより構成される。

（１）支柱部
（２）カセッテホルダー部
（３）電動昇降架台
（４）昇降踏台
（５）安全手摺り
（６）操作パネル

詳細は装置付属の取扱説明書「第２章」を参照してください。

２）各部の名称

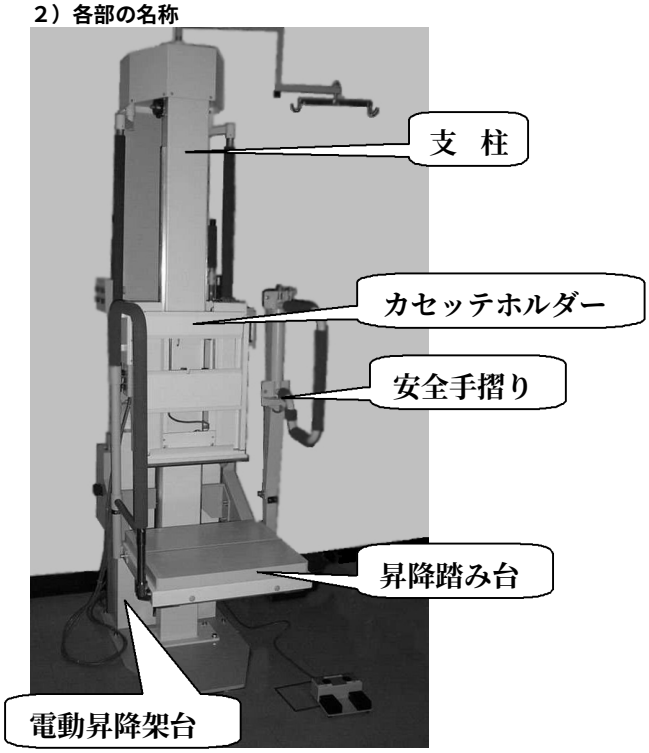

３）電気定格

定格電圧	単相　１００Ｖ
周波数	５０/６０Ｈｚ
電源入力	０．５ＫＶＡ
保護の形式	クラスⅠ
保護の程度	Ｂ形

電気安全規格：JIS T 0601-1:2002 に適合している。

４）本体寸法及び質量

寸法本体（㎜）	幅 549	高 2330	奥行 872
質量	約 200Kg		

【性能、使用目的、効果・効能】

１）仕様　　（単位mm）

電動昇降部
踏台上下移動　　床上 105～525　（ストローク 420）
カセッテホルダー
カセッテサイズ　　長尺縦～六切縦横
電磁オフロック方式＋電動上下動

２）使用目的

この装置は長尺カセッテが使用でき、又、車椅子からの移動が容易で座位撮影にも適した立位撮影台です。

３）効能又は効果

長尺カセッテを使用して、立位脊椎、立位下肢全体等の撮影が電動昇降台にて位置決めが簡便にできます。

取扱説明書を必ずご参照下さい。

各部重要固定部	１年	固定ねじの増し締め

【操作方法又は使用方法等（用法・用量含む）】

使用環境条件

温度　　１０～４０℃
湿度　　３０～８５％

設置上の注意

①装置の設置は傾きの無い様に設置してください。
②本体をアンカーボルト等で床に固定して使用して下さい。

操作方法

カセッテを装填して、上下のロックを外して、立位撮影のポジショニングを行う。

【使用上の注意】

禁忌・禁止

この装置は防爆型ではないので、装置の近くで可燃性及び爆発性の気体を使用しないこと。

重要な基本的注意

①検査を開始する前に装置に異常がないこと、構成品、付属品が確実に固定されていることを確認すること。（各ストッパ関係）
②カセッテホルダーを移動させるときは、患者の手足等が挟まれないよう注意すること。
③検査中は、患者の様子や動作を常に注意すること。特に意識のない患者、身体に障害のある患者、精神に問題のある患者の検査中の状態については細心の注意を払うこと。

その他の注意事項

この装置を廃棄する場合は、産業廃棄物となり、必ず地方自治体の条例・規則に従い、許可を得た産業廃棄物処分業者に廃棄を依頼すること。
詳細は装置付属の取扱説明書を参照してください。

【作動・動作原理】

カセッテホルダーの上下懸垂方式はカウンターバランス方式でチェーン吊り、電動、及び手動上下です。

【貯蔵方法及び使用期間等】

１）使用耐用年数（自己認証）
　指定された保守点検を実施した場合に 10 年
２）定期交換部品
　各部固定ストッパ
　カセッテホルダー用ベルト
　電動アクチュエータ
　リチュームイオン電池

詳細及び保守部品の保有年数については取扱説明書を参照してください。

【保守・点検に係る事項】

１）使用者による保守点検事項

項目	点検頻度	点検内容（概要）
他の機器との干渉	日常	目視にて確認
電動昇降台の動作	日常	動作確認
各部ｽｯﾄｯﾊﾟｰ動作	日常	固定動作の確認

２）業者による保守点検事項

項目	点検時期	点検内容
懸垂ﾍﾞﾙﾄの点検	１年	ヒゲやネジレの確認
電動昇降台	１年	ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞの動作確認

＊＊【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者：三共医療機株式会社
住所：大阪市平野区加美東６－１４－２２
TEL：（０６）６７９４－１６００
FAX：（０６）６７９４－１６０６
製造業者：三共医療機株式会社
住所：大阪市平野区加美東６－１４－２２

取扱説明書を必ずご参照下さい。